


ソフトウェアをバージョンアップしました。

リードマイハートで測定した不整脈心電図のサンプルと説明文を追加しましたので、測定した心電図を不整脈心電図のサンプルと比較できます。

操作方法是取扱説明書 [3.5.10 不整脈心電図例](#)を確認ください。

下の画面は心室期外収縮の例です。

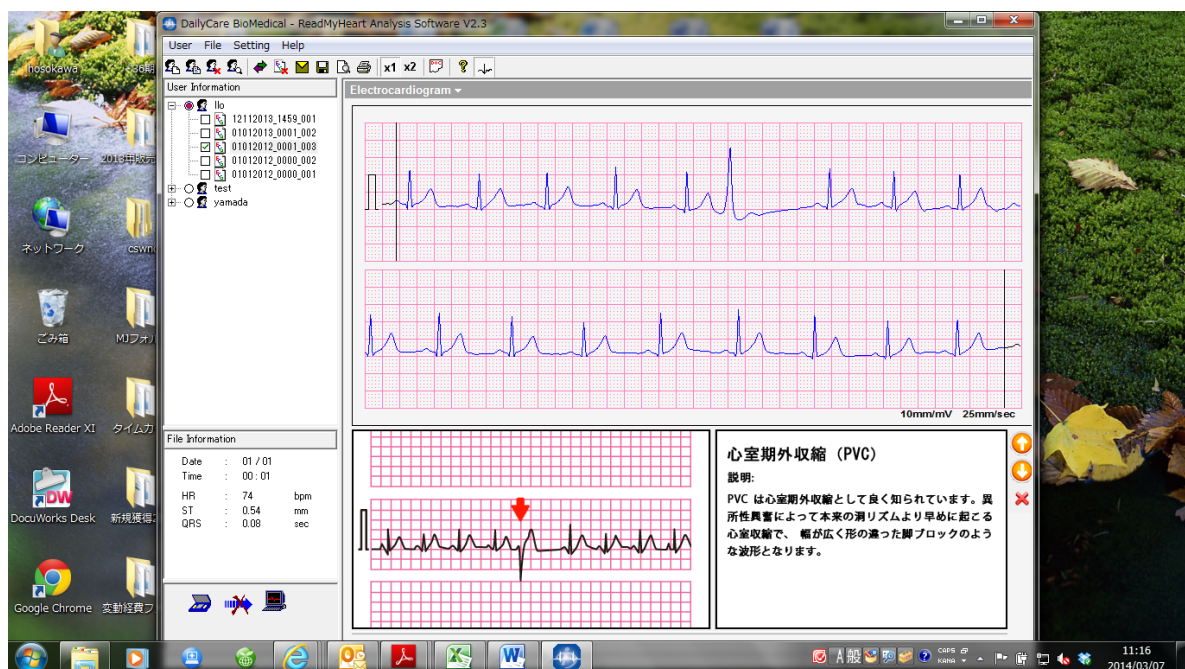

2014年3月7日